



TENGA | SVR PLUS

SMART VIBE RING PLUS

使用說明書

為了讓您能安全正確的使用本產品，
使用前請務必詳閱使用說明書。




3 使用注意

- 首次使用前和每次使用後，請確實洗淨。此外，請勿使用熱水或放進水裡煮沸。
- 請於涼爽乾燥處保存，避免陽光直射。以免產生故障、過熱、起火等。
- 保養本產品時請勿使用香蕉水、苯、酒精或熱水，以免造成變形、變色。
- 請勿將本產品放置於嬰幼兒可觸碰之處，以免因誤食而造成身體不適。
- 請勿重摔或強力衝擊，以避免觸電、短路或故障。
- 疲勞、酒醉時請勿使用本產品，以免造成身體不適。
- 請勿靠近暖爐或接近火源使用，抽煙時請勿使用。以免引起火災。
- 請於淡水中使用，遠離海水，以免產生故障。
- 請勿將本體長時間浸水，以免產生故障。
- 使用中若有身體不適現象，請立即停止使用並儘快就醫，以免發生意外或產生不適情況。
- 為預防性病，請勿與他人共用本產品。
- 同一部位請勿連續使用 15 分鐘以上。
- 使用完畢後請關機，以免產生意外或受傷。
- 請務必確保 USB 充電器正確連接，以免產生故障、過熱、起火等。
- 充電時請勿開機，以免產生故障、過熱、起火等。
- 不要过度弯曲或拉扯USB充电器。

- 請勿於產品上堆疊重物，及靠近發熱器械。以免引起觸電或起火。
- 充完電請及時拔除 USB 充電器，積累灰塵或濕氣入侵可能導致短路、漏電、起火等。
- 請及時清除 USB 接口上的灰塵，以免灰塵過多引起短路。

4 警告

- 請勿用力拉扯外部矽膠，以免造成產品損壞。
- 請勿將外部矽膠剝離，以免產品故障、起火、動作異常等。
- 請勿自行拆解、修繕或改造本產品，以免造成產品起火或動作異常、受傷等意外事件。
- 使用人工心臟起搏器等醫療電子儀器，或患有其他疾病正在接受醫師治療等使用者，使用本產品前請先徵詢醫師意見。
- 若有外傷或紅腫、發炎、發疹等部位，請勿使用本產品。
- 若產品發生故障或感覺到動作異常，為避免發生意外，請即刻停止使用並關閉電源。
- 清潔前請拔除 USB 充電器。
- 請勿於雙手潮濕時，插拔 USB 充電器，以免觸電。
- USB 充電器損壞、接頭鬆弛時請勿繼續使用。以免造成觸電、短路、起火等。如果繼續使用，會有造成觸電、短路、火災的可能性。
- 請勿使用超過 5V1A 的 USB 電源轉接器或電腦，可能會造成產品故障。

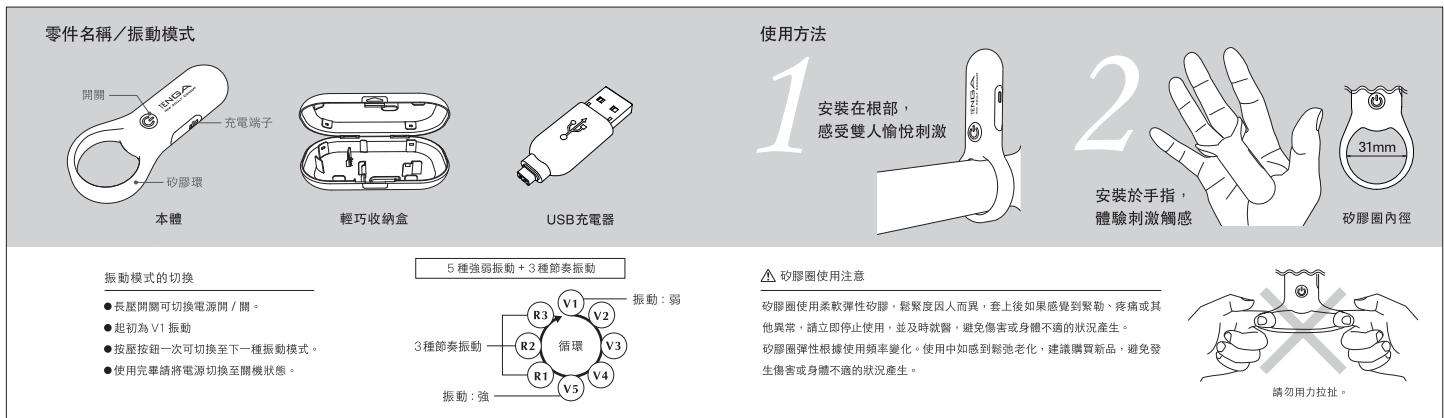

1



2



7



8

9

2

10